

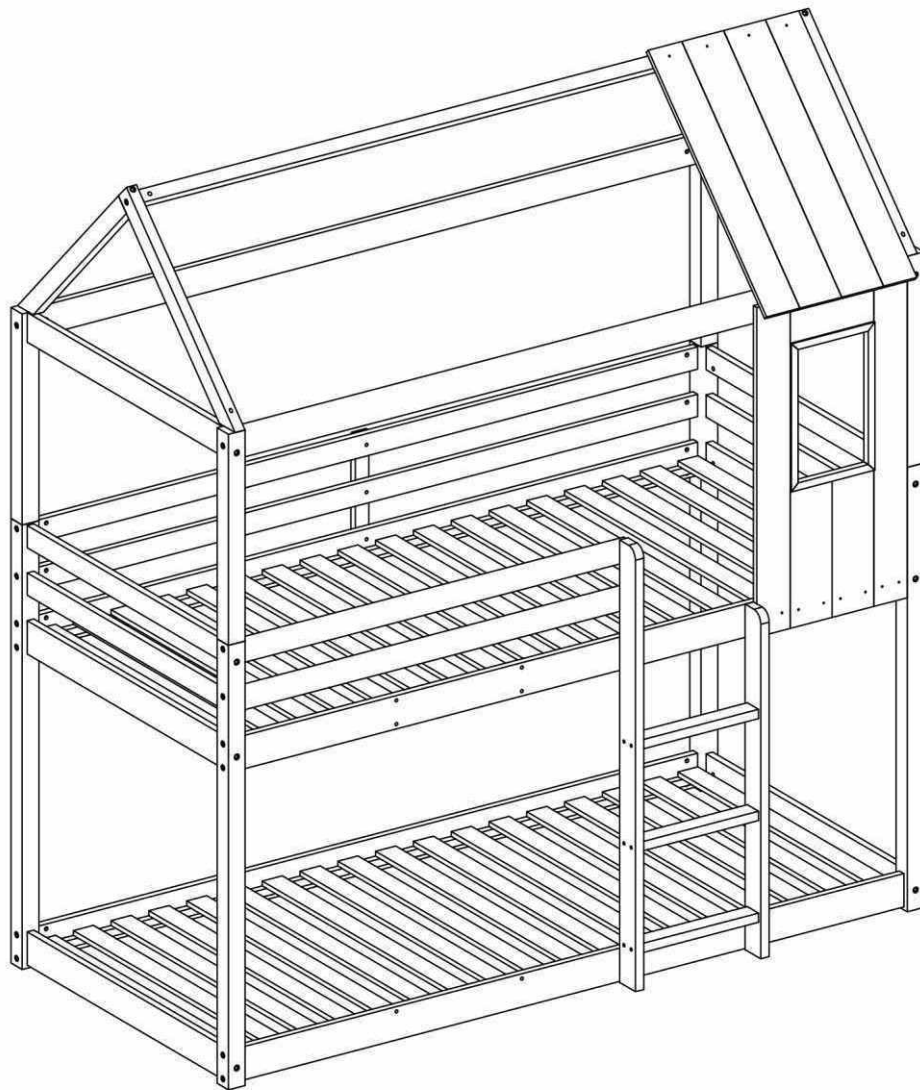






ATRISA

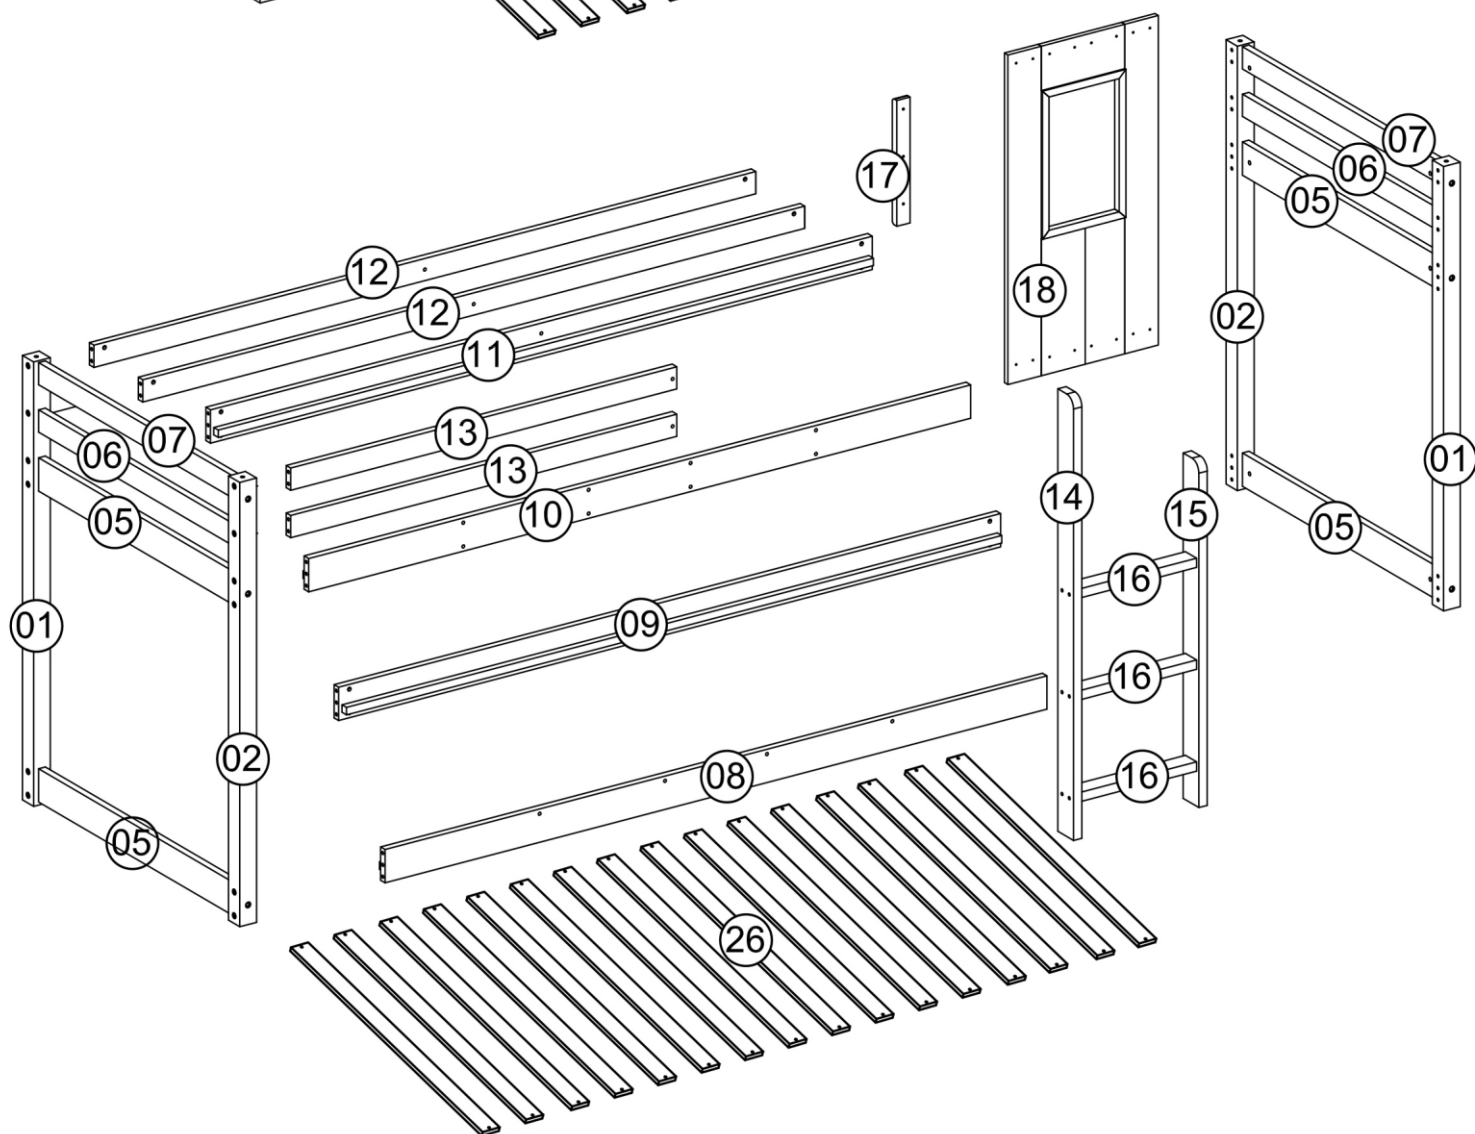


A	 M6x90mm	42
B	 M6x30mm	03
C	 M6	44
D	 $\Phi 8 \times 30 \text{mm}$	60
E	 $\Phi 7 \times 60 \text{mm}$	20
F	 $\Phi 4 \text{mm}$	12
G	 $\Phi 6 \times 100 \text{mm}$	06

H	 M6x70mm	02
I	 30+30*16mm	02
J	 $\Phi 4 \times 30 \text{mm}$	84
K	 $\Phi 4 \times 16 \text{mm}$	04
L	 M6x40mm	05
M	 $\Phi 10 \times 82 \text{mm}$	04

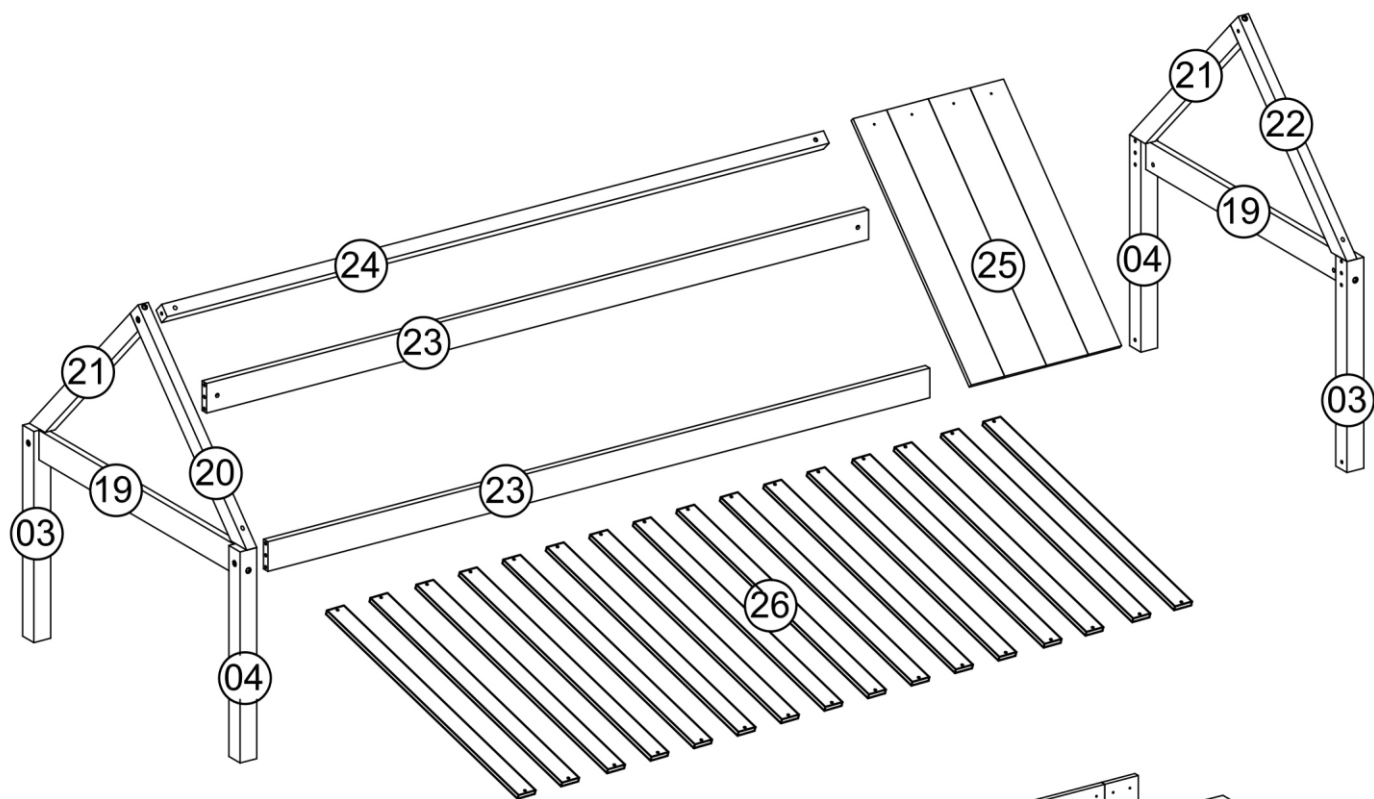


1

x2

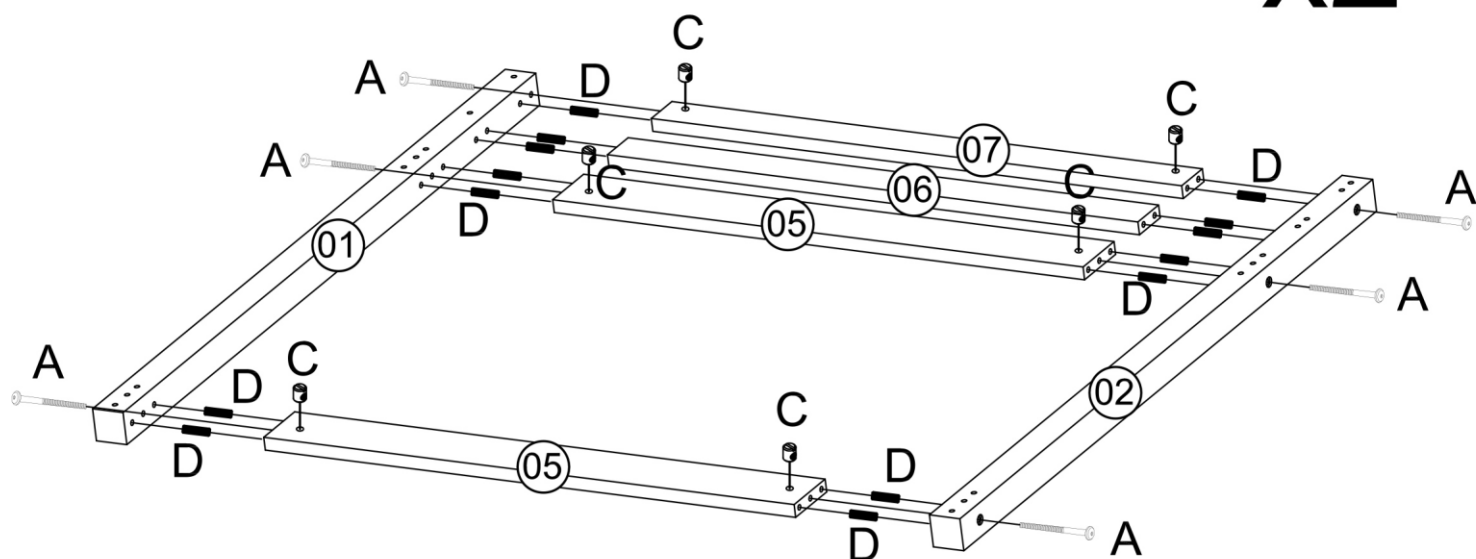


A	 M6x90mm	12
C	 M6	12
D	 $\Phi 8 \times 30 \text{mm}$	28


2

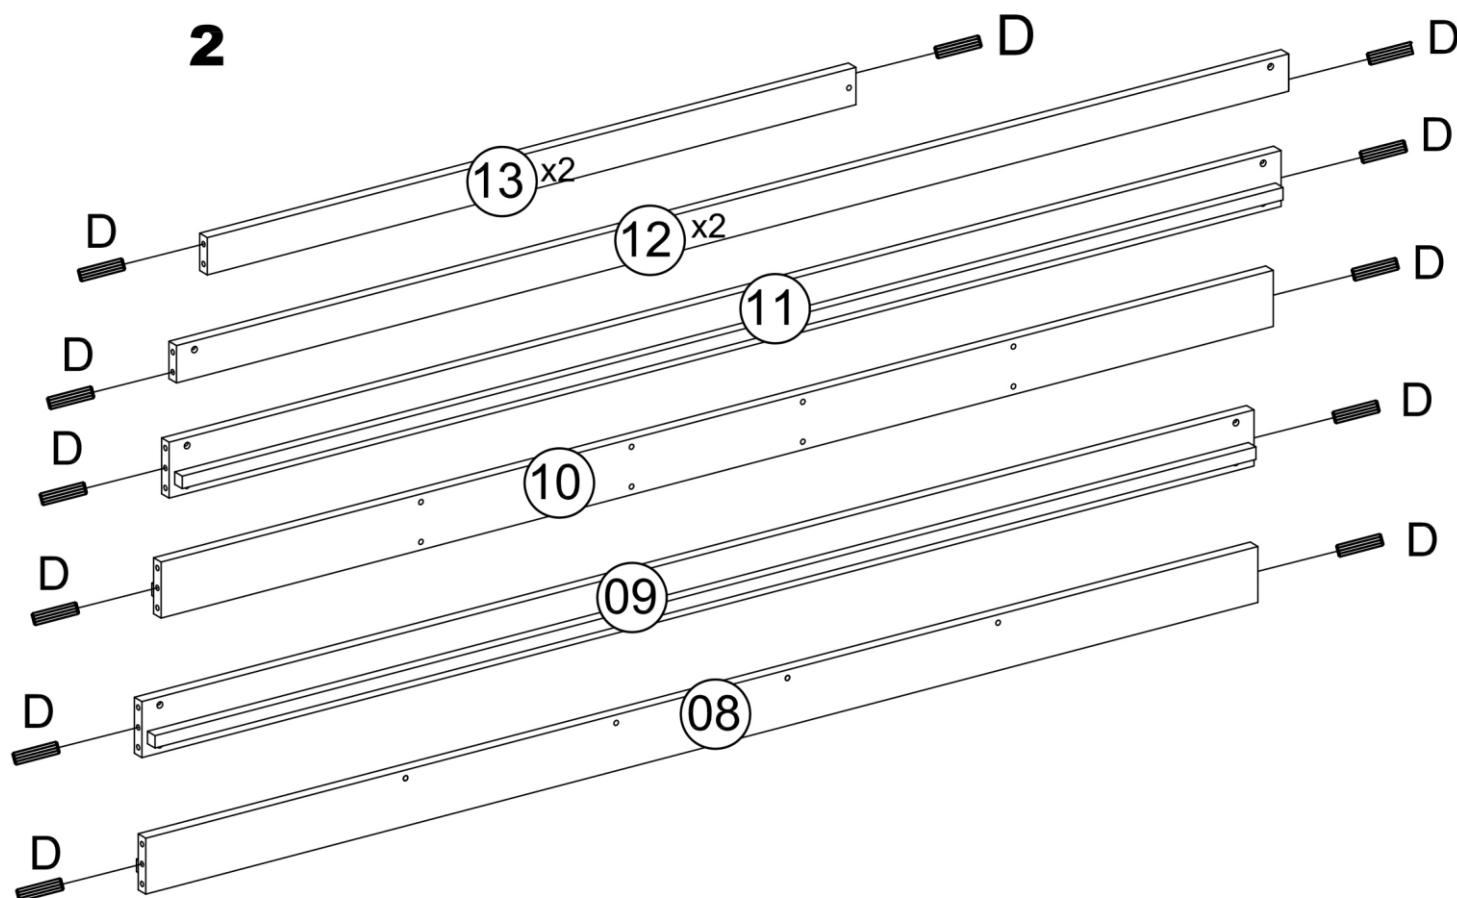


D	 $\Phi 8 \times 30 \text{mm}$	16
---	--	----



3

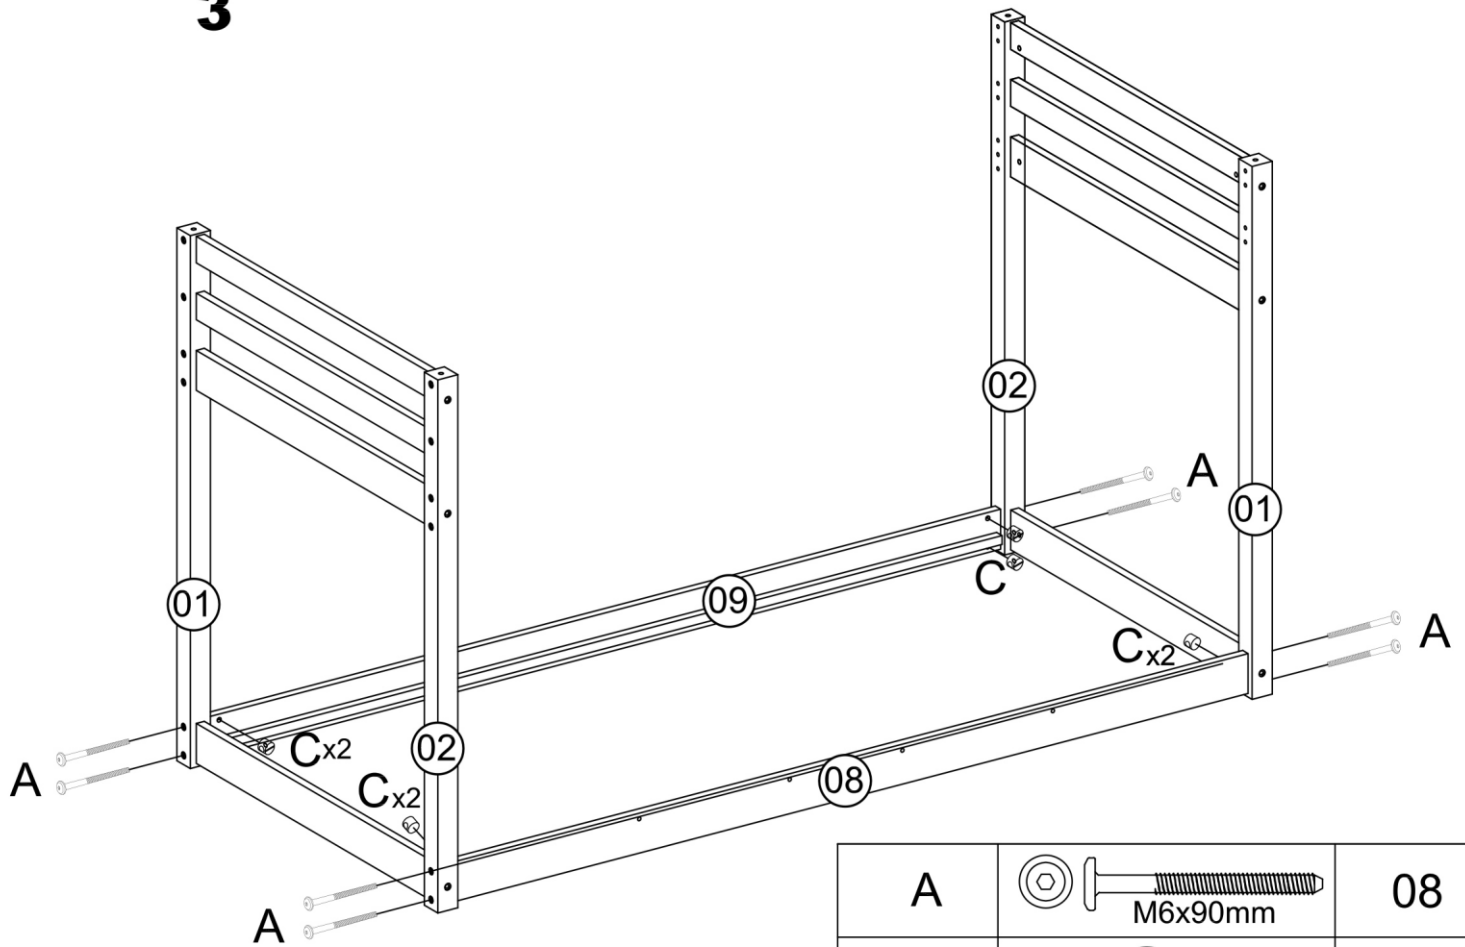


A		08
C		08


4

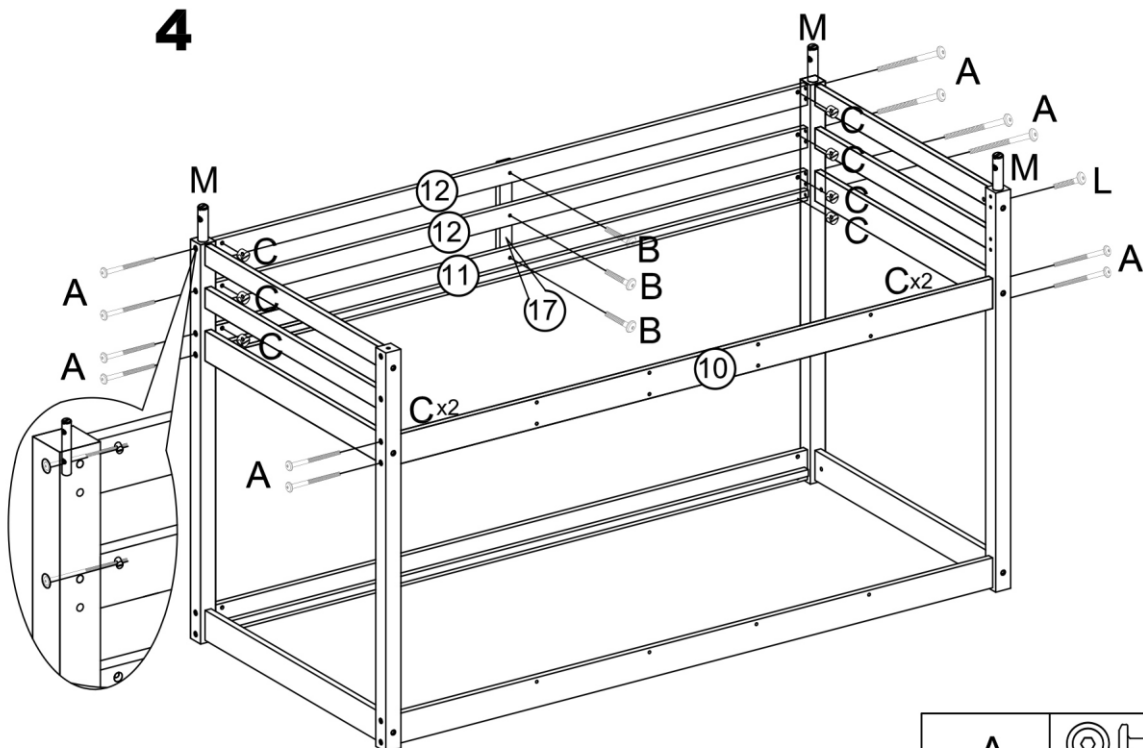


A		12
B		03
C		12
L		01
M		03


5

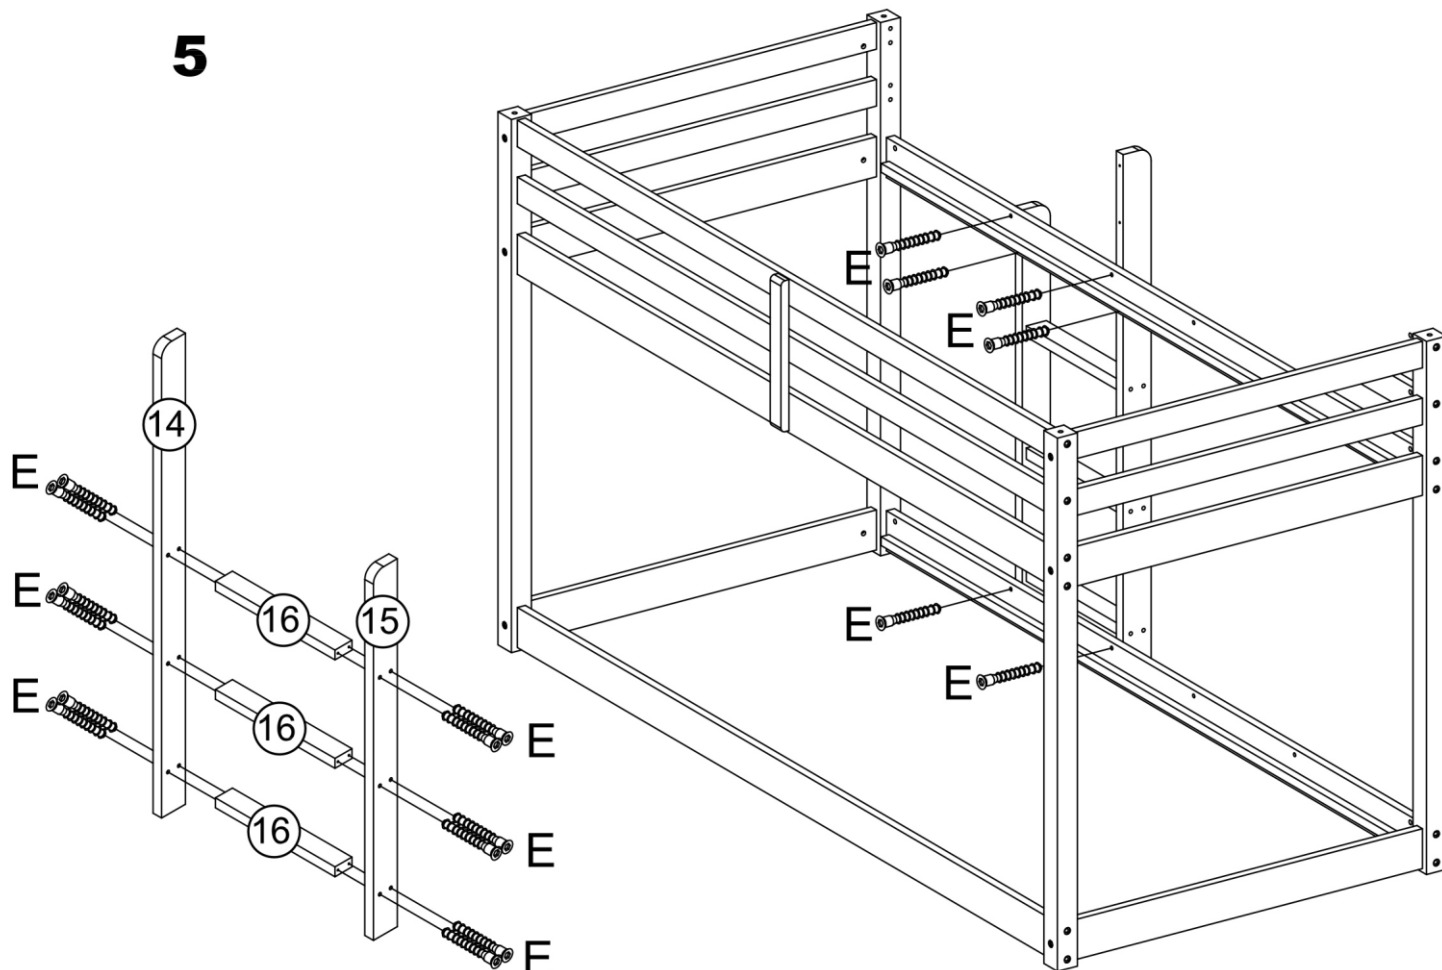


E	 $\Phi 7 \times 60 \text{mm}$	18
---	--	----


6

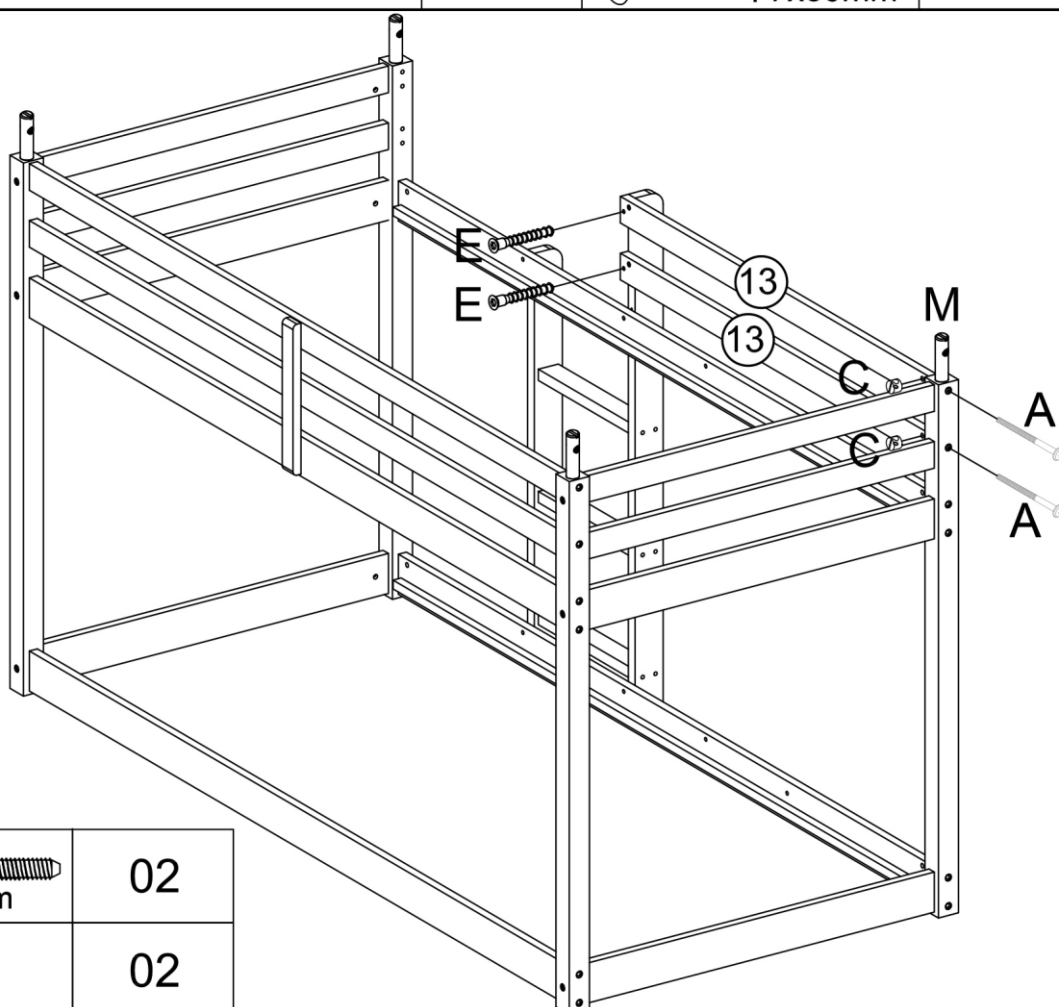

A	 $M6 \times 90 \text{mm}$	02
C	 M6	02
M	 $\text{Ø}10 \times 82 \text{mm}$	01


E	 $\Phi 7 \times 60 \text{mm}$	2
---	--	---

7

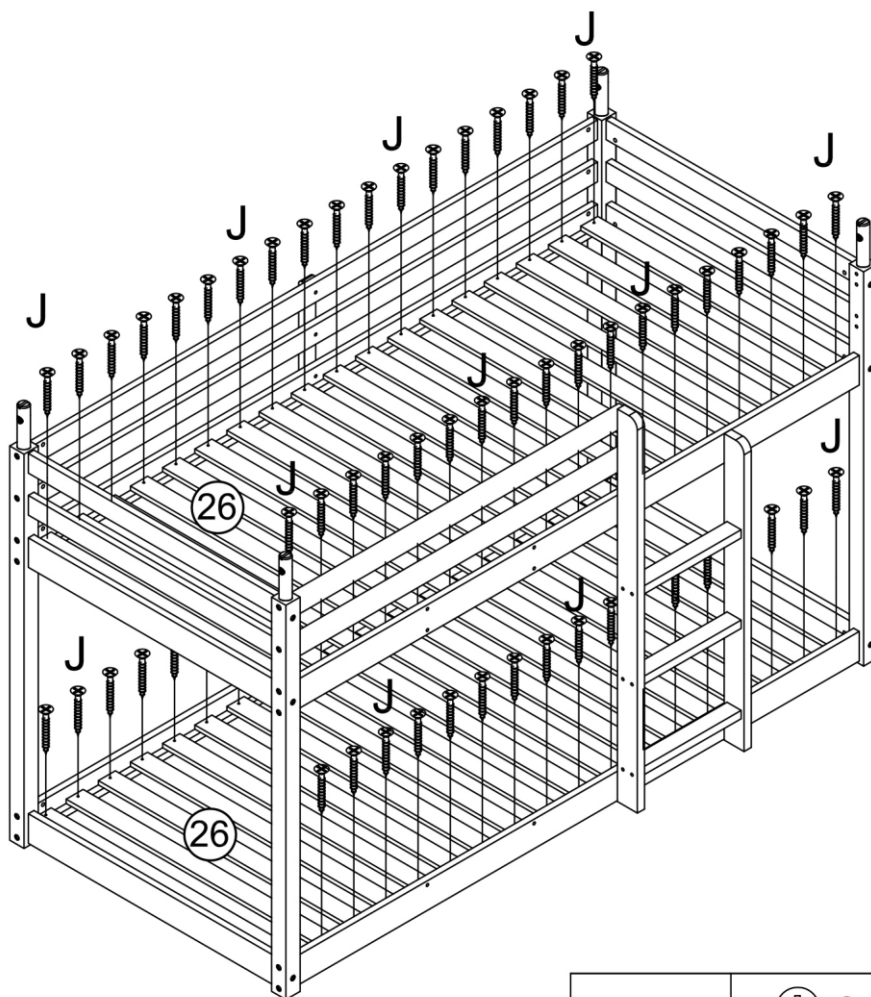


J	  $\Phi 4 \times 30 \text{mm}$	64
---	--	----

8

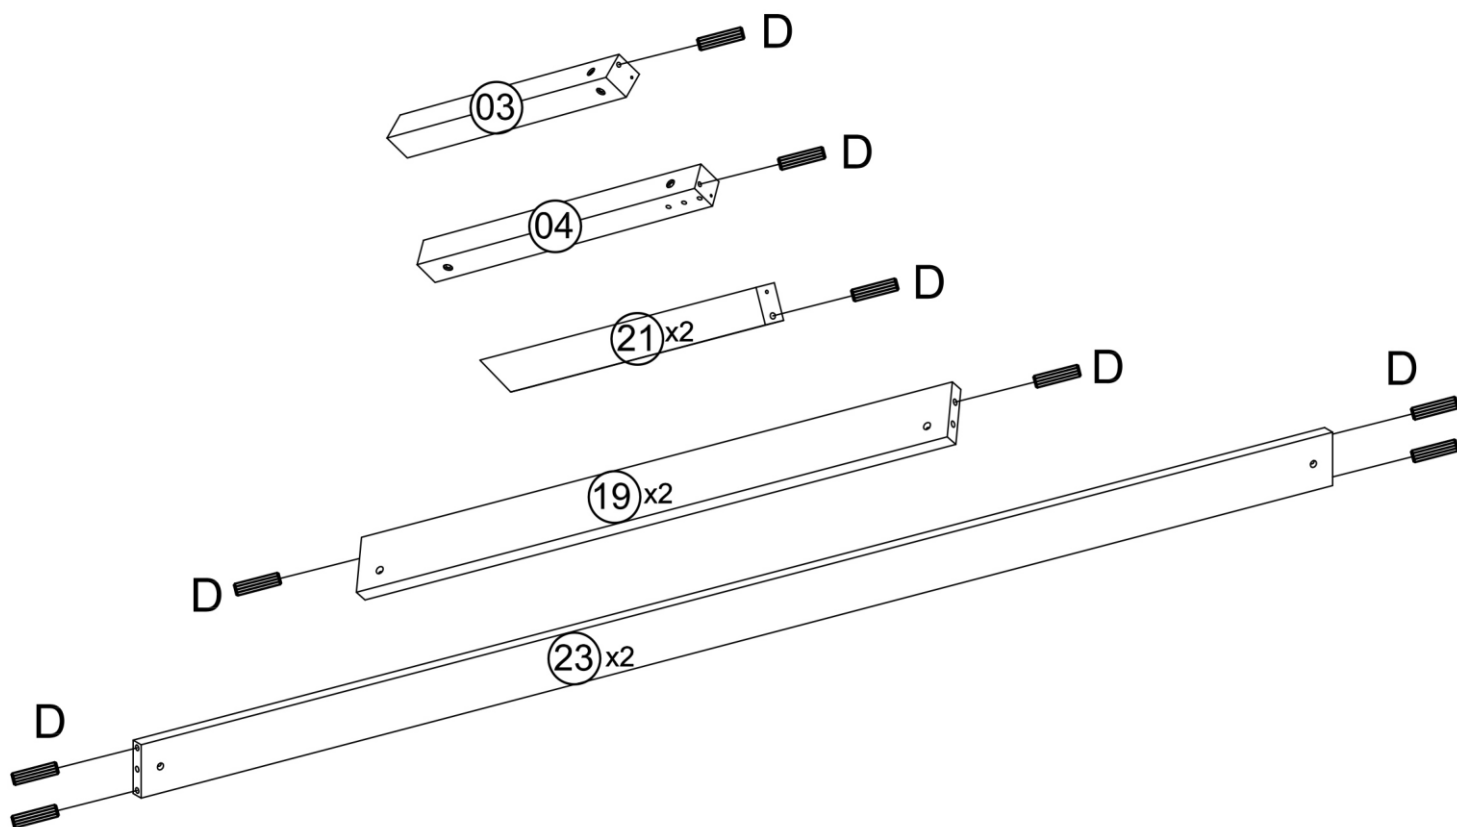


D	 $\Phi 8 \times 30 \text{mm}$	16
---	--	----


9

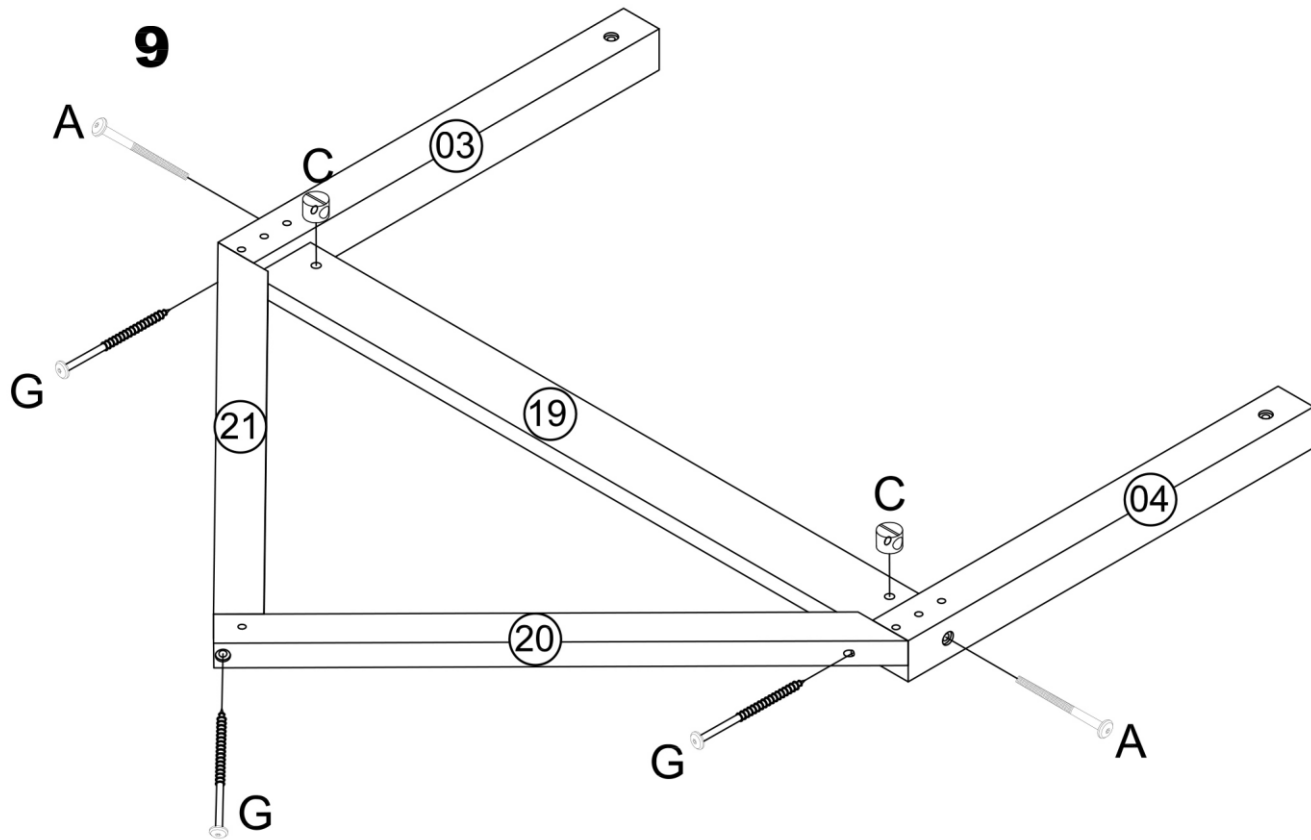


A	 M6x90mm	02
C	 M6	02

G	 Ø6x100mm	03
---	--	----


10

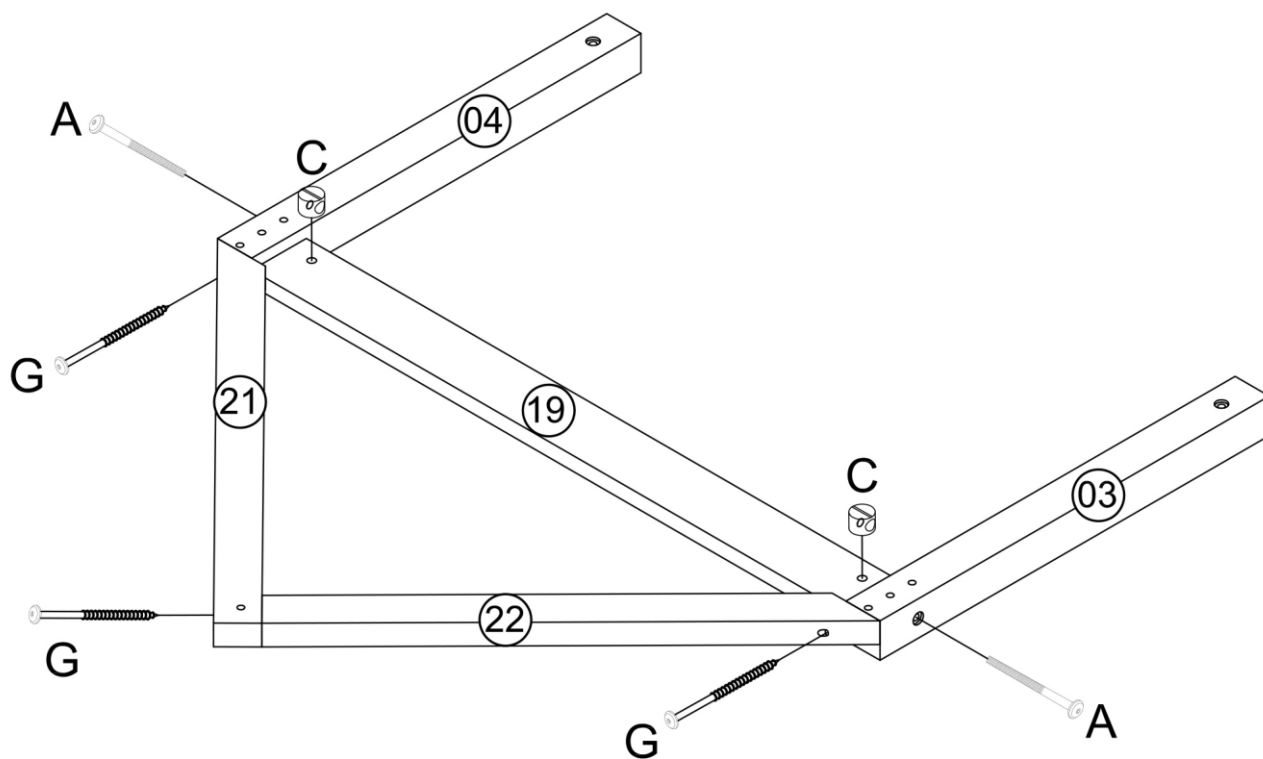

A	 M6x90mm	02
C	 M6	02


G	 Ø6x100mm	03
---	--	----


11

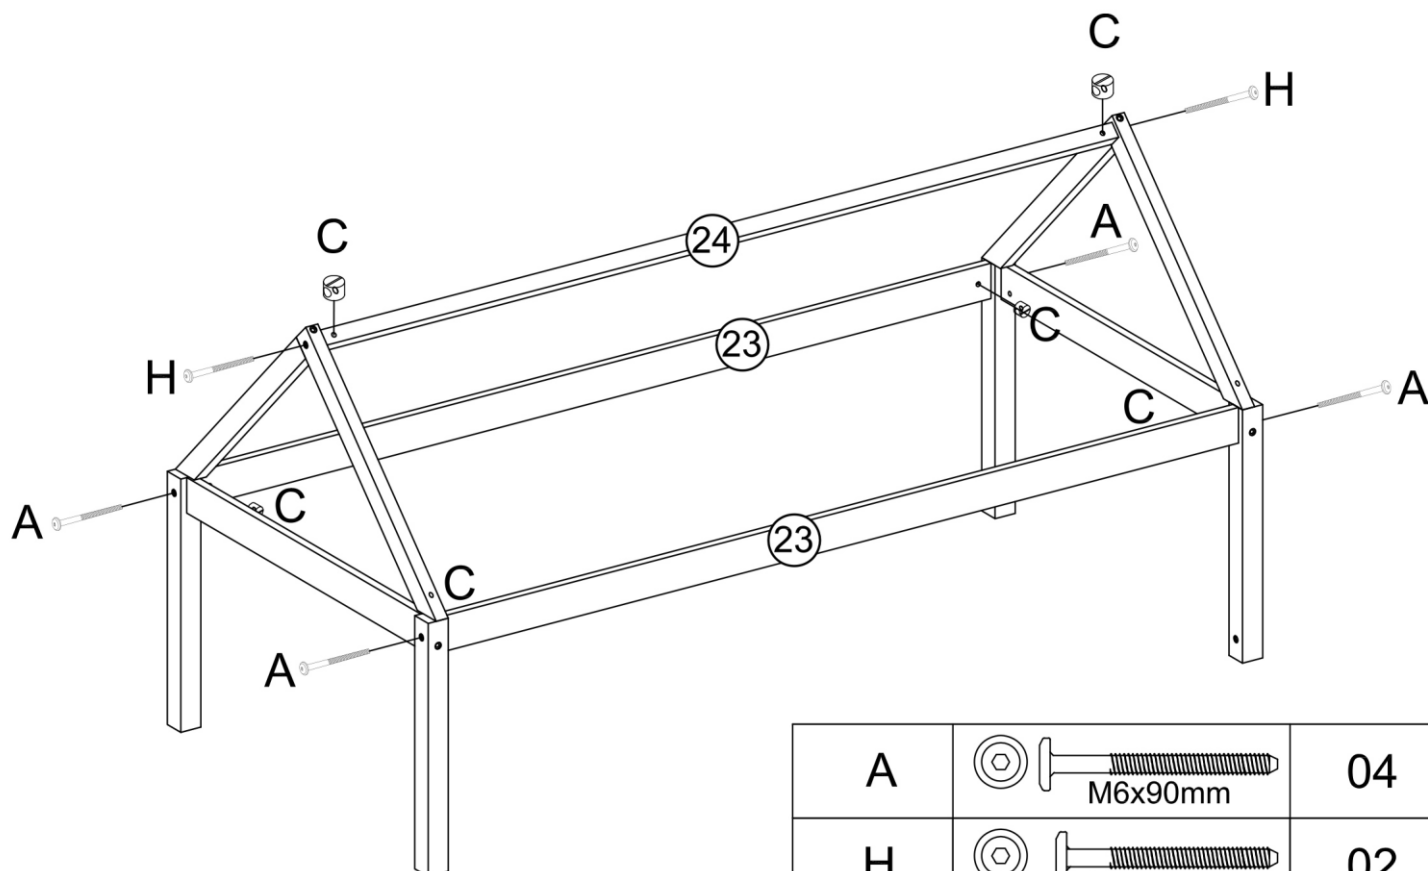


A	 M6x90mm	04
H	 M6x70mm	02
C	 M6	06

12

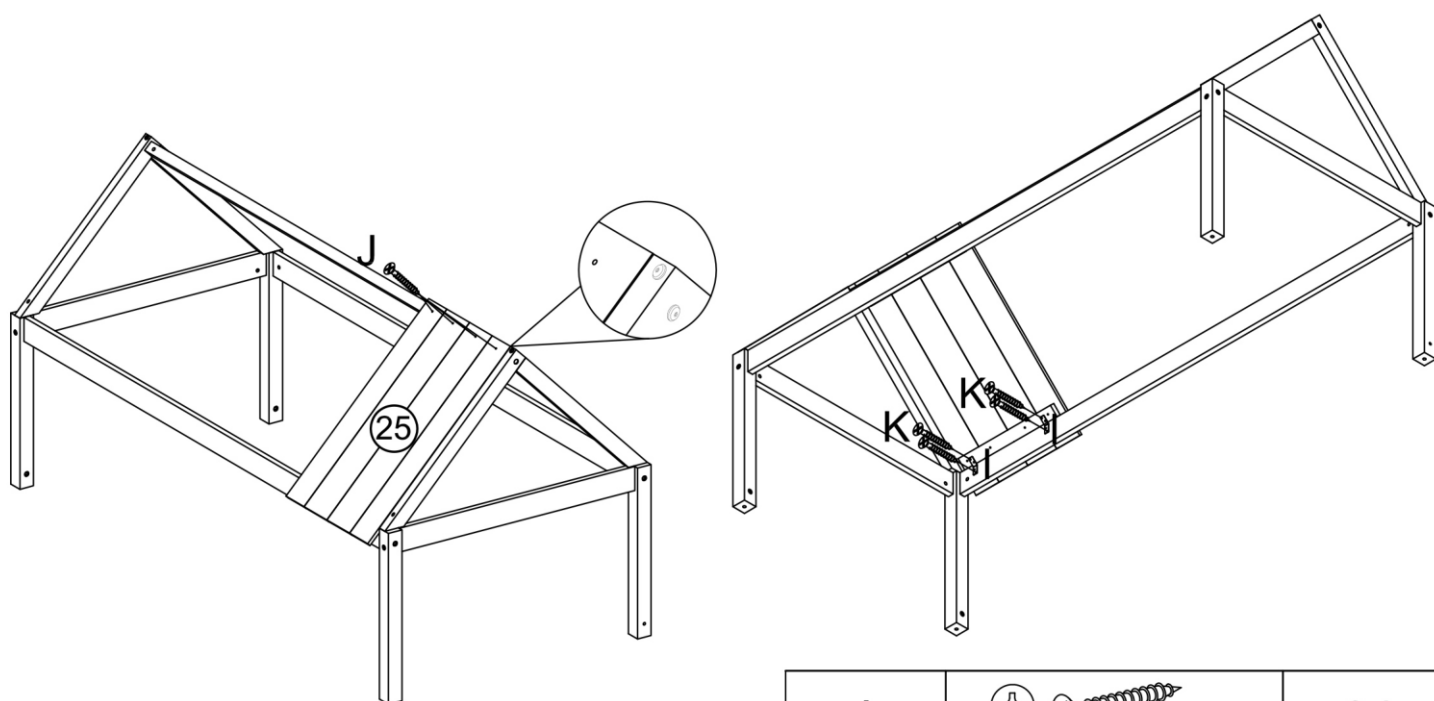


J	 $\Phi 4 \times 30 \text{mm}$	04
I	 30+30*16mm	02
K	 $\Phi 4 \times 16 \text{mm}$	04

13

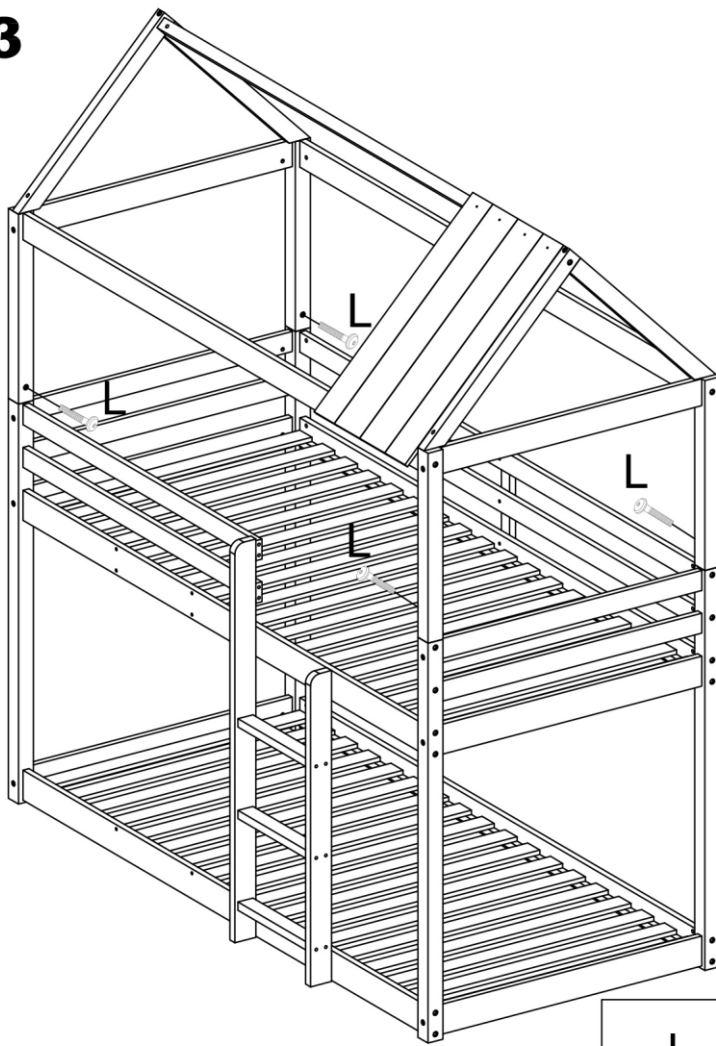


L



M6x40mm

04

14

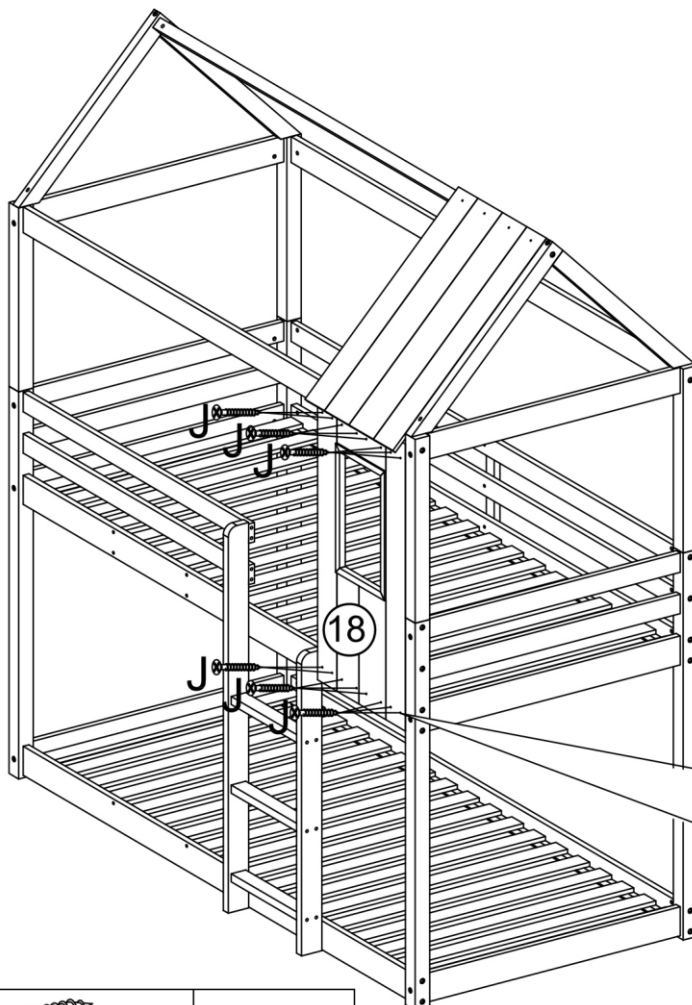


J



Φ4x30mm

16

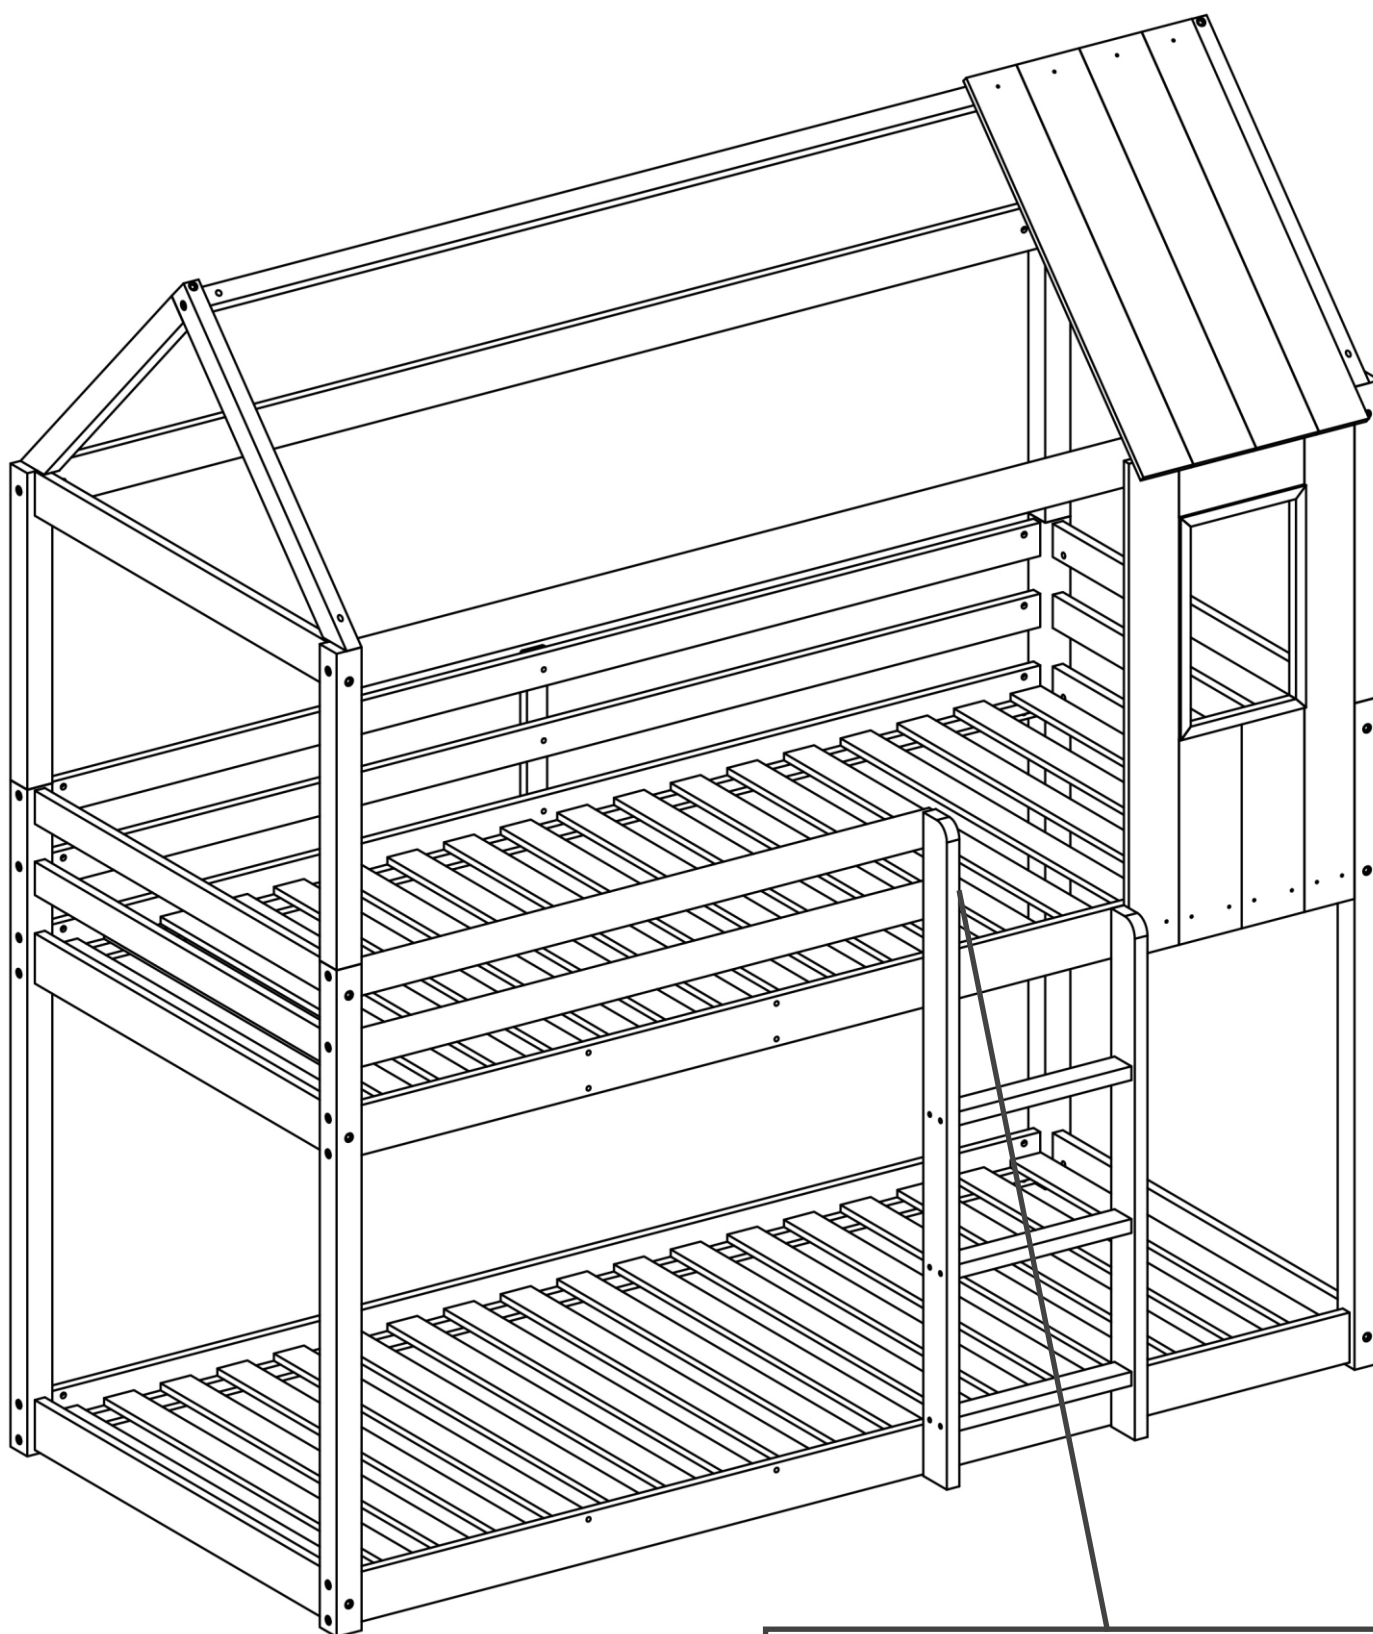**Fontos megjegyzés:**

A matrac felső széle nem haladhatja meg a vonallal jelölt határt
- a matrac felső széle, és az akadály széle közötti távolság min. 16 cm
okrajom bariéry by mal byt' min. 16 cm
(lásd a mellékelt képet: matrac elhelyezése)

STN EN 747-1 a STN EN 747-2

Matrac elhelyezése a felső ágyakon, padlószint felett 80 cm-rel az emelt ágyon

